


1. **Messung** am 10.09.2017 an weiblicher Testperson, 46 Jahre alt,

Messgerät: *ROFES E01C Screening System*

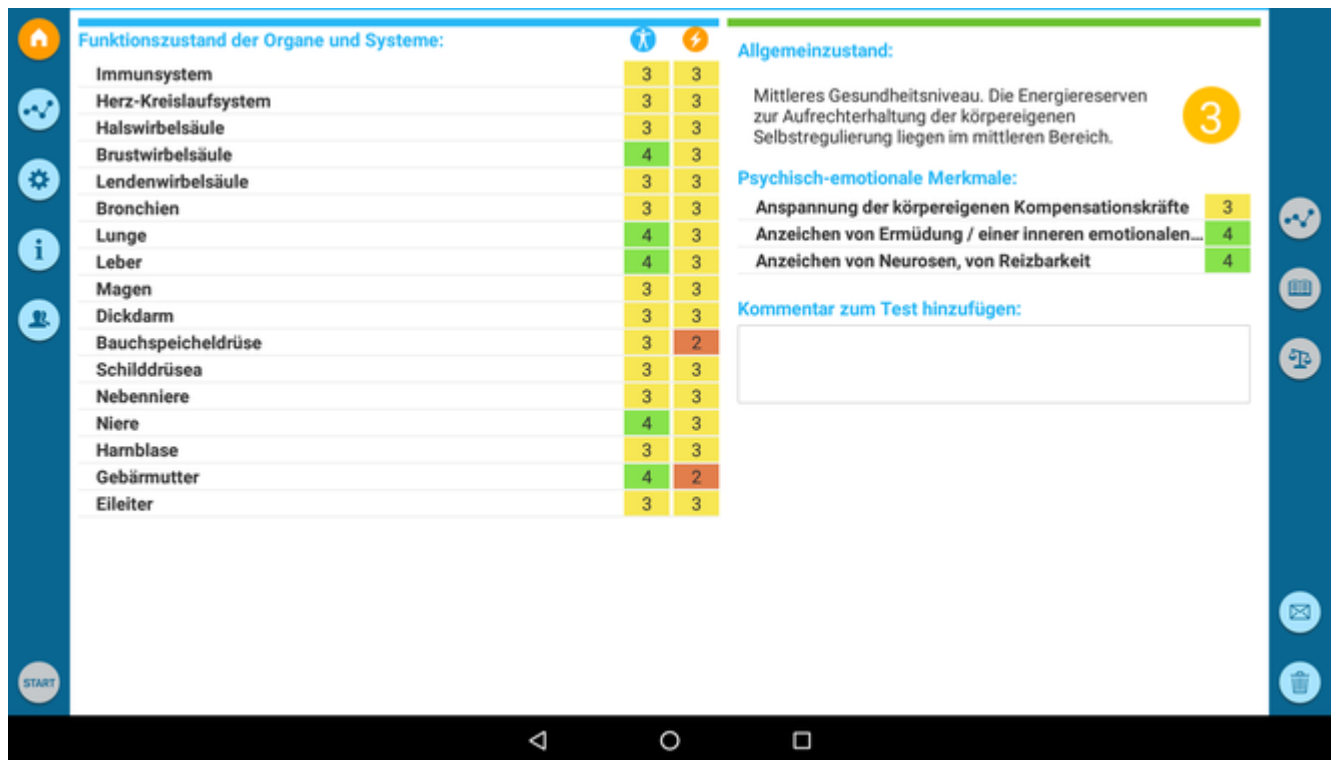

2. **Messung**, gleiche Testperson, 60 Min. nach Messung 1 und 60 Min. nach permanenter Anwendung eines EO#2

Alle relevanten Messwerte 4-5 (gut bis sehr gut). Einzig im Bereich "Anspannung der körpereigenen Kompensationskräfte" ist eine vorübergehende Verschlechterung festzustellen, was zum Testzeitpunkt der situationsbedingten Aufregung der Testperson vor Messung 2 geschuldet ist.

